



REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA	
QEVERIA E KOSOVES-VLADA KOSOVA-GOVERNMENT OF KOSOVA	
MINISTRIA E SHENDETESISË-MINISTARSTVO ZDRAVLJA-MINISTRY OF HEALTH	
Njësia Org. Org. Jedinica Org Unit	Nr. Prot. Broj Prot. Prot. No.
09	05-4615
Nr. i faqeve Br. stranica No. pages	Data: Datum: Date:
-51-	17/06/2025
Prishtinë / a	

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health

Divizioni i Prokurimit/Divizije nabavke/Procurement Division

KONTRATË PUBLIKE

FURNIZIM

**“Furnizim me pajisje të Ultrazërit dhe pajisje për Terapinë
Okupacionale për Njësitë Shëndetësore të Burgjeve”**

Lot 1- Pajisje të Ultrazërit

Numri i Kontratës: 206-25-1452-1-2-1/C863

Numri i Prokurimit: 206-25-1452-1-2-1

Operatori ekonomik: **MADEKOS SH.P.K.**

NUI: 811560293

KONTRATË

Numri i kontratës ¹: 206-25-1452-1-2-1/C863

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

MADEKOS SH.P.K., Vragoli (Magjistralja Prishtinë-Pejë), Fushë Kosovë, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizim me pajisje të Ultrazërit dhe pajisje për Terapinë Okupacionale për Njësitë Shëndetësore të Burgjeve me numër identifikues: 206-25-1452-1-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë furnizim nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Lot ²	Artikulli ² Specifikat	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi në TVSH (€)	Çmimi total në TVSH (€)	Prodhuesi dhe vendi i origjinës
1	Ultrazë Profesional	copë	2	17,999.00 €	35,998.00 €	SonoScape Medical Corp, Kina

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **45** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Njësitë e Burgjeve të Republikës së Kosovës**.

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë DDP (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **35,998.00 €**; [Tridhjetepesëmijë e nëntëqindnëntëdhjetetë mije] Euro.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Kjo marrëveshje e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

- (e) Oferta financiare;
- (f) Katalogu i pajisjes;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.



Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ³ në dy origjinale, Një original është për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

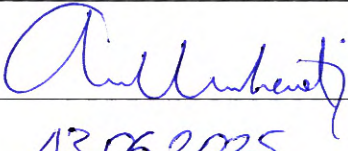Për Autoritetin Kontraktues,		Për Operatorin Ekonomik	
Emri:	Berat Marmullaku	Emri:	VISAR HODA
Pozita:	Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit	Pozita:	MENAXHER
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	13.06.2025	Data:	16.06.2025
Vula:		Vula:	

³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 206-25-1452-1-2-1/C863

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Ne rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimin të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimin.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet te jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

- i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimin, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe
- ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i përmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te përmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimin.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim te ai.

11.5 Para pranimin të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualët e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualët dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në forma dhe numrat të tilla të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimin të përkohshëm deri sa manualët dhe vizatime e tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humb këtë të drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mbledhen në rastet kur një Furnizuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të

barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskoje garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrat për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimi, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimi.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19

Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

19.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'i japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohej se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës që duhet t'i behet Furnizues sipas kësaj Kontrate do të specifikohen në KVK.

20.2 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 Shumat duhet të paguhesh brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendrike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;

- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj. Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguheshin ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkthazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve

të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimi përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

27.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtësore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të

regullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 29.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

30.5 Nëse Furnizuesi shkaktonte kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shumën e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31**Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

31.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes

Neni 32**Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 206-25-1452-1-2-1/C863

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amendamentimët/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	9.1	10 % e vlerës së kontratës për kohëzgjatjen e periudhës prej 75 ditëve.
Sigurimi	10.1	n/a
Programi i ekzekutimit	11	Sipas planit të menaxhimit të kontratës, brenda afatit kohor për liferim 45 ditë.
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Patentat dhe licencat	13.1	<u>[Specifikoni nëse ka ndonjë shmangie nga Neni 13 i KPK]</u>
Cilësia e furnizimeve	18.2	Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform Aneksit 1 (te dosjes të tenderit).

Inspektimi dhe testimi	19.2	Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet e implementimit.
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorëzuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues.
Dorëzimi	21.3	Dorëzimi behet ne Njësitë e Burgjeve te Republikës se Kosovës Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të pakëtohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda 45 ditëve pas marrjes së "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	24.1	Garancionit të përgjithshëm për pajisjet e ofruara së paku 24 muaj gjatë së cilës Kontrakti duhet të kryejë servisim pa pagesë shtesë, mbështetje teknike dhe zëvendësimin e pjesëve rezerve.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Menaxheri dhe mbikqyresi i kontratës, DSHB, Div. i Prokurimit dhe Dep. Ligjor në MSh.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedurë gjyqësore	32.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë.

Prokurimi: 206-25-1452-1-2-1

Nr i brendshëm:

Titulli: Furnizim me pajisje të Ultrazërit dhe pajisje për Terapinë Okupacionale për Njësitë Shëndetësore të Burgjeve

1 Lot 1- Pajisje të Ultrazërit

Kodi i tenderit: 206-25-1452-121

Data: 18.04.2025

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	Dok e kompanise dhe Lista e Furnizimeve.rar
2.	Deklarata OE dhe Specifikimi teknik.pdf
3.	Dok e prodhuesit Lot 1.rar

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Lot 1- Pajisje të Ultrazërit	Cmimorja Lot 1 pdf.pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

N/A

AUTORITETI KONTRAKTUES

MINISTRIA E SHËNDETËSISË, ZAGREBIT , P.N., -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 206-25-1452-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **MADEKOS SH.P.K., Vragoli (Magjistrallja Prishtinë-Pejë), 12000, Fushë Kosovë, Kosovë**

E-mail: **made-kos@hotmail.com**

Personi kontaktues: **Ardian Buzuku**

Telefoni: **+383 49555461**

Faxi:

Numri fiskal: **811560293**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 206-25-1452-1-2-1

Titulli i kontratës: Furnizim me pajisje të Ultrazërit dhe pajisje për Terapinë Okupacionale për Njësitë Shëndetësore të Burgjeve

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Lot 1- Pajisje të Ultrazërit

3. Çmimi total i tenderit është:

35,998.00 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **150** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK


8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

LOT 1 - Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Nr	Artikulli - Specifikat	Njësia matëse	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Çmimi total me TVSH (€)	Prodhuar dhe vendi i origjinës
1	Ultrazë Profesional teknike sipas Aneks 1 te DT	Specifikat copë	2	€ 17,999.00	€ 35,998.00	SonoScape Medical Corp, Kina



Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i oe:	MADEKOS.sh.p.k.
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të oe:	Ardian Buzuku
Nënshkrimi:	
data:	18.04.2025
vula:	

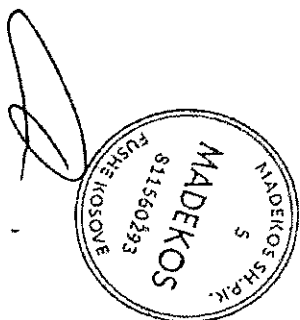


Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër	FPF	Sasia apo fushëveprimi	Informacione shtesë
Grupi 1.	Lot 1- Pajisje të Ultrazërër	Lot 1- Dy Ultrazë Profesional	33000000-0	Tre Ultrazë Profesional	
Grupi 2.	Lot 2- Pajisje për Terapinë Okupacionale	Lot 2- Pajisje për Terapinë Okupacionale	32321200-1	39 artikuj me sasi sipas përshkrimit të çmimit	

LOT 1 - Ultrazë Professional

Specifikat	Njësia matëse	Sasia
Ultrazë Professional 1.1 Digital color Doppler ultrasound system designed for various clinical applications. 2 CLINICAL APPLICATIONS To ensure maximum clinical utilization, the system should provide imaging capability for: 2.1 General abdominal imaging 2.2 Breast / thyroid / small parts imaging 2.3 Musculoskeletal imaging 2.4 Urology / prostate imaging 2.5 Bi-plane trans-rectal imaging 2.6 Ultrasound guided interventional procedures 2.7 Adult and pediatric echocardiography 3 TECHNICAL SPECIFICATIONS 3.1 All-digital broadband beamforming technology 3.2 Beamformer with a 14-bit Analog/Digital converter. 3.3 The Beamformer shall have ability to process 16384 grey scales of shades 3.4 The system shall be with programmable waveform transmission 3.5 The system dynamic range shall not be less than 290dB	Cope	2

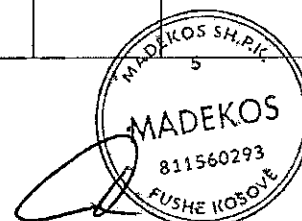

3.6 The system should be able to simultaneously process the frequency range from 1 MHz (or lower) to 16 MHz (or higher)

3.7 Convex probe Frequency range 1.0 to 7.0 MHz or wider

3.8 Linear probe Frequency range shall be from 4.0-16.0MHz or more

3.9 Capable of not less than 13 stages of transmission focus

3.10 The system should have at least 1TB hard disk size, or more

4 IMAGING MODES

Full digital color Doppler ultrasound system, capable of operating in, but not limited to, the following modes:

4.1 Real-time 2-Dimensional gray scale imaging (B-mode)

4.2 Power Doppler Imaging with flow direction indication, or DPDI

4.3 Pulsed-wave Doppler with High PRF capability

4.4 Panoramic view in B mode, Color and Power mode

4.5 Tissue Doppler Imaging

4.6 Real-time Tissue Elastography

4.7 Real-time 3D mode, or 4D mode

5 Function and configuration

5.1 Adjustable frequency in B mode shall not be less than 5-band including fundamental wave and harmonic wave

5.2 Capable of Widescan to enlarge the imaging area to display more information

5.3 Capable of Color panoramic imaging

5.4 Capable of 3D/4D

5.5 Capable of advanced 3D/4D rendering that enhances border of the surface structure and displays transparent inner structure with a virtual light source

5.6 Capable of automatic follicle recognition and size measurement in 2D mode with one click

5.7 Capable of endometrium recognition and thickness measurement in 2D mode with one click

5.8 Capable of compression elastography on Linear, convex, TV probes

5.9 Capable of ECG detection

5.10 Integrate AI into real-time B-mode fetal scanning, standardizing and automating the obstetric ultrasound workflow based on ISUOG guidelines. Simplify prenatal



screening, improve efficiency, and enable less experienced operators to perform basic examinations.		
5.11 Supports at least 27 standard planes and 13 measurements automatically.		
5.12 Intelligent one-button automatic recognition of hip joint structure		
5.13 Automatic measurement of hip joint values (included α Angle, β Angle and FHC) for easy Graf classification		
6 Available Languages		
6.1 Software: English, Simplified Chinese, Spanish, Russian, French, Italian, German, Norwegian, Portuguese, Japanese, Dutch, Polish and Czech		
6.2 Keyboard: English and Simplified Chinese, Latin, French and Polish		
7 Physical specifications		
7.1 Size and Weight:		
7.1.1 Width: shall not be wider than 550mm		
7.1.2 Depth: shall not be longer than 750mm		
7.1.3 Weight: shall not be more than 84Kg, without peripheral devices		
7.2 Monitor		
7.2.1 21.5-inch or larger		
7.3 Touch Screen for controls		
7.3.1 Full color 13.3 inch or larger capacitive touch screen, which enables easy navigation of controls and system interaction.		
7.4 Control Panel		
7.4.1 The panel buttons shall be with backlight design for darker room operation		
7.4.2 Multiple defined keys shall be equipped		
7.5 Probe port and probe holder		
7.5.1 With no less than 5 transducer sockets		
7.5.2 Port for pencil probe shall be equipped		
7.5.3 Not less than 7 probe holders shall be equipped		
7.5.4 Gel warmer shall be equipped		
7.5.5 Not less than 2 cable hangers shall be equipped		
7.6 Others		
7.6.1 The equipment and its accessories should comply with		




	the safety requirements of IEC 60601 or equivalent		
	7.6.2 The equipment and its accessories should remain in full operation throughout the voltage qf: 115/200 to 240V $\pm$ 10%, 50 or 60 Hz		
	7.6.3 The system should be FDA or CE certified. A copy of the certificate should be submitted with the offer.		
	7.6.4 Built-in battery shall be available and support continuous work for no less than 1.5h		

LOT 2: Lista e mjeteve te nevojshme per zbatimin e udhezuesit - zbatimin e programit psikosocial me aktivite okupuese per trajtimin e rasteve me probleme te shendetit mendor ne burgje

Tabela: Përshkrimi/Specifikat, dhe Specifikimet e Artikullit për secilin mjet:

Nr.	Mjeti	Përshkrimi/Specifikat	Specifikimet e Artikullit	Sasia	Njësia
1	Karta standarde të lojës në format fizike	Set kartash për lojë me 52 karta	Letra të plastifikuara, 52 karta, madhësia standarde 6 x 9 cm.	50	set
2	Puzzle - seti i copëzave të figurave	Set për zhvillimin e aftësive motorike dhe mendore, mosha 5-9 vjeçare	100 copëza, material druri ose plastike, përmban figura të ndryshme.	50	set
3	Rruzaria (rosary)	Përdoret për meditimin dhe përqendrimin, ka ngjyra dhe madhësi të ndryshme	Perla, sfera, material plastike, 33 ose më shumë sfera, gjatësi 45-50 cm. Ngjyra të ndryshme.	80	set
4	Emotional Charts	Pllaka për ndihmën në identifikimin dhe shprehjen e emociojoneve	Pllaka kartoni ose plastike, përfshin figura të emociojoneve të ndryshme.	10	copë
5	TV	Përdoret për aktivite vizuale dhe edukative	Ekran LCD, 42"-51", mundësi lidhje me pajisje të jashtme përmes HDMI, WIFI dhe Bluetooth.	4	copë
6	Katalog me shenja për orientim në hapësira të urbanizuara	Përdoret për orientimin dhe udhëzimin në hapësira urbane	Karta plastike, ngjyra të ndryshme, 50-100 shenja për orientim.	10	copë
7	Videq lojëra	Lojëra për zhvillimin e aftësive motorike dhe mendore	Aparati PlayStation 5 ose Intendo.	4	copë
8	Topa për lojë	Topa për zhvillimin e aftësive motorike dhe për aktivite fizike	Gomë, madhësi 15-30 cm, ngjyra dhe forma të ndryshme.	50	copë
9	Plastelina	Material për krijim dhe zhvillimin e aftësive kreative dhe motorike	Set ngjyrash plastelina, 10 ngjyra të ndryshme, pa substanca të dëmshme.	100	sete
10	Biofeedback dots	Pajisje për monitorimin e reagimeve trupore për terapi relaksuese	Pika për Biofeedback, material i sigurt, 100 copë për paketim.	5	sete
11	Kolltukë për	Kolltukë komode dhe të	Material i qëndrueshëm,	10	copë





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGENCIA E REGJISTRIMIT TE DUNGESVE NE KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKAT E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811560293

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

MADEKOS SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

MADEKOS

Emri tregtar / Trgovacko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:


Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Vragoli, Fushë Kosovë, Kosovë 846
Vragoli
Fushë Kosovë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

12/04/2021



12/04/2021

Data / Date / Datum

Nënshkrimi / Signature / Potpis

[illegible]



Specifications for P40 Elite Series Digital Color Doppler Ultrasound System

901-08212-A05


Page 1

Contents

1	General Specifications	7
1.1	Applications	7
1.2	Probe Types.....	7
1.3	Imaging Modes.....	7
1.4	Features	7
1.5	Languages	8
2	Physical Specifications.....	8
2.1	Dimension and Weight.....	8
2.2	Monitor.....	8
2.3	Touch Screen.....	8
2.4	Control Panel.....	8
2.5	Speaker.....	8
2.6	Caster	8
2.7	Probe Port and Probe Holder.....	9
2.8	Power	9
✧	Working Environment.....	9
2.9	Storage and Transportation Environment.....	9
3	Annotation and Body Mark.....	9
4	Monitor Information	9
5	Image Parameter	9
5.1	Overview	9
5.2	B Mode.....	9
5.3	M Mode.....	10
5.4	Anatomical M Mode	10
5.5	CFM Mode.....	10
5.6	PDI/DPDI Mode.....	10
5.7	PW Mode	10
5.8	SR Flow.....	11
5.9	CW Mode.....	11
5.10	TDI Mode.....	11
5.11	TDI+PW Mode.....	11
5.12	TDI+M Mode	11
6	Advanced Features.....	11
6.1	Micro F.....	11
6.2	Widescan Imaging.....	11
6.3	Zoom	12
6.4	Customized Preset.....	12
6.5	Freehand 3D.....	12
6.6	Static 3D/4D.....	12
6.7	CFM 3D	13
6.8	PDI 3D	14

6.9	SR Flow 3D.....	14
6.10	STIC.....	15
6.11	FreeVue.....	16
6.12	Volume Contrast Imaging.....	16
6.13	S-Spine.....	16
6.14	Vocal.....	16
6.15	Panoramic Imaging.....	16
6.16	Biopsy Guide Function.....	16
6.17	Vis-Needle.....	16
6.18	C-xlasto (Compression Elastography).....	16
6.19	Contrast Imaging.....	17
6.20	Stress Echo.....	17
6.21	G-MQA.....	17
6.22	R-MQA.....	17
6.23	Sono-Help.....	18
6.24	Sono Assistant.....	18
6.25	Sono-Drop.....	18
7	Measurement/Analysis and Report.....	18
7.1	Measurement settings.....	18
7.2	Basic Measurement Package.....	18
7.3	Report.....	18
7.4	S-Fetus.....	19
7.5	S-PF.....	19
7.6	S-Endo/S-Follicle.....	19
7.7	S-Hip.....	19
7.8	Auto Measurement.....	19
8	Storage and Data Management.....	19
8.1	Storage.....	19
8.2	Data Management.....	19
8.3	Cine Review.....	20
9	Connectivity.....	20
9.1	I/O Port.....	20
9.2	Video Output Settings.....	20
9.3	Network Connection.....	20
9.4	DICOM 3.0.....	20
10	Probe.....	21
10.1	Convex Array Probe.....	21
10.2	Linear Array Probe.....	22
10.3	Phased Array Probe.....	23
10.4	Volume Probe.....	23
10.5	Specialty Probe.....	23
11	Peripheral Devices and Accessories.....	24
11.1	Printer.....	24
11.2	Foot Switch.....	24

11.3	USB Bar Code Scanner	24
11.4	DVD R/W Drive	24
12	Safety and Certification.....	24

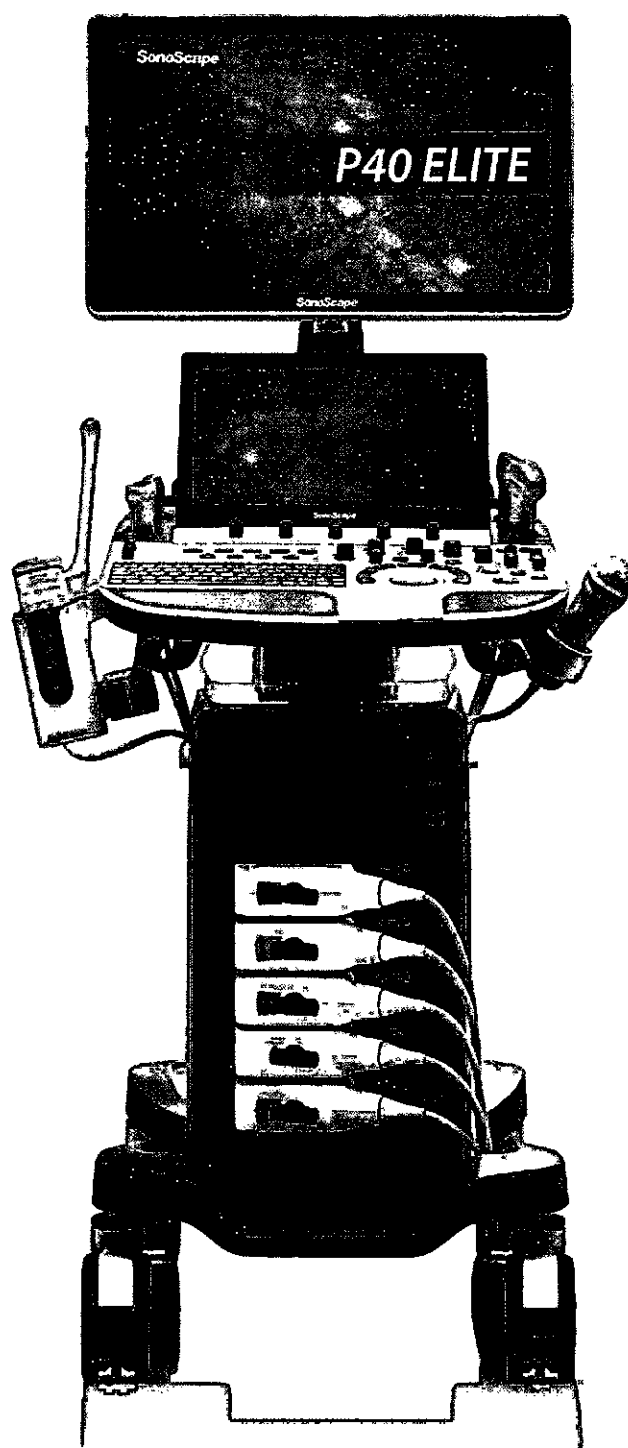

1 General Specifications

1.1 Applications

- Abdomen
- Cardiology
- OB/Gynecology
- Musculoskeletal
- Vascular
- Small parts
- Urology
- Pediatrics
- TCD
- Breast
- Intraoperative

1.2 Probe Types

- Convex array probe
- Linear array probe
- Phased array probe
- Volume probe
- Pencil probe
- Biplane probe

1.3 Imaging Modes

- B
- THI/PHI/SPHI
- M
- Anatomical M
- Color M
- CFM
- PDI/DPDI
- PW
- CW
- TDI
- TDI+PW
- TDI+M

1.4 Features

Standard Features

- 5-band adjustable frequency in B mode (fundamental wave and harmonic wave)
- μ -Scan
- HQ Scan
- Compound Imaging

- LGC (8-band)
- Tissue Specific Index
- Image Rotation
- Trapezoid Imaging
- SR Flow (High Resolution Flow)
- HPRF (High Pulse Repetition Frequency)
- Micro F (Slow Flow Imaging of Microvascularized Structures)
- Bright Flow (Three-dimensional Visualization of Blood Flow)
- Simultaneous Mode (Triplex)
- PW Auto Trace
- Auto IMT
- Auto NT
- Auto EF
- Auto Bladder
- S-Follicle
- S-Endo
- Auto OB plus
- S-MSK
- Scr-Zoom
- HD-Zoom
- B Mode Panoramic Imaging
- Color Panoramic Imaging
- Biopsy Guide
- Vis-Needle
- Freehand 3D
- C-xlasto
- ECG
- TDI (Tissue Doppler Imaging with Quantitative Analysis)
- Sono Assistant
- Sono-Drop
- Show Gallery
- Sono-Help

Optional Features

- S-Fetus
- S-PF
- 3D/4D Module
- S-Live & S-Live Silhouette
- S-Live Contour
- S-Depth
- Color 3D
- STIC
- Auto Face

- S-Spine
- VCI
- FreeVue
- AVC Follicle
- Vocal
- Contrast Imaging with TIC Analysis
- MFI
- MFI Time
- Mix Mode in Contrast Imaging
- Stress Echo
- G-MQA
- R-MQA
- S-Hip

1.5 Languages

- Software: English, Simplified Chinese, Spanish, Russian, French, Italian, German, Norwegian, Portuguese, Japanese, Dutch, Polish and Czech
- Keyboard: English, Simplified Chinese, Latin, French and Polish
- User manual: English and Simplified Chinese

2 Physical Specifications

2.1 Dimension and Weight

- Width: approx. 550 mm
- Depth: approx. 740 mm
- Height:
 - approx. 1085 mm to 1680 mm with 21.5-inch monitor
 - approx. 1085 mm to 1740 mm with 23.8-inch monitor
 - (The lowest height is measured when the control panel, the upper swivel arm and the monitor are adjusted to the lowest position; The Highest height is measured when the control panel, the upper swivel arm and the monitor are adjusted to the highest position)
- Weight: approx. 83.7 Kg

2.2 Monitor

- Monitor:
 - 21.5-inch medical high resolution monitor
 - 23.8-inch medical high resolution monitor (Optional)

- Resolution: 1920×1080
- Viewing angle: 178°(horizontal), 178°(vertical)
- Swivel angle: ±40°
- Up/down angle:
 - 90° to 25° (21.5-inch monitor)
 - 90° to 45° (23.8-inch monitor)
- Contrast and brightness: 0 - 100 adjustable
- Monitor Arm
 - Upper swivel arm can be rotated left and right, relative to lower swivel arm. Swivel angle: ±110°
 - Upper swivel arm can be adjusted up and down, relative to lower swivel arm. Swivel angle: 0° to 40°
 - Lower swivel arm can be rotated left and right, relative to main body. Swivel angle: ±50°

2.3 Touch Screen

- 13.3-inch medical high resolution monitor
- Resolution ratio: 1920×1080
- Viewing angle: 170° (horizontal), 170° (vertical)
- Adjustable inclination angle range: 0° to 15°
- Brightness and contrast: adjustable
- Available to touch with latex gloves
- User-defined parameter preset layout
- Anti-glare and anti-fingerprints

2.4 Control Panel

- User-oriented design
- Backlight design
- Multiple user-defined keys
- TGC: 8 levels slider controls
- Trackball sensitivity: adjustable
- Swivel angle (left/right): -40° to 40° (from center)
- Adjustable height range: 0 to 230 mm
- Full-sized backlit keyboard on the panel

2.5 Speaker

Hi-Fi Speaker

2.6 Caster

- Diameter: 5 inches

- Specification: all the 4 casters can be independently locked

2.7 Probe Port and Probe Holder

- Probe ports: 5
- Pencil probe port: 1
- Endocavity probe holder: 1
- Probe holder: 7
- Gel holder: 1
- Gel warmer: 1
- Cable hanger: 2
- Cable holder: 2

2.8 Power

- 100-127V/220-240V~
- Frequency: 50/60HZ
- Maximum power output: 500VA
- Built-in battery (charging time ≤ 9 h; power supply time > 1.5 h)
- System boot up time: approx. ≤ 85 s
- System shut down time: approx. ≤ 32 s
- Entry time for standby: ≤ 10 s
- Exit time for standby: ≤ 38 s
- SSD (Solid state drive)

❖ Working Environment

- Temperature: 0°C to 45°C (10°C to 45°C when used with 4D probe)
- Relative humidity: $\leq 90\%$ RH
- Atmospheric pressure: 700hPa - 1060hPa
- System noise: ≤ 55 dB

2.9 Storage and Transportation Environment

- Temperature: -20°C to +55°C
- Relative humidity: $\leq 95\%$ RH
- Atmospheric pressure: 700hPa - 1060hPa

3 Annotation and Body Mark

- All exam applications included
- Annotation: text annotation and arrow annotation
- Manual text annotation by touch screen
- Front size of text annotation: adjustable
- Initial position: user-defined

- Preset text annotation
- Arrow direction: adjustable
- Body marks: ≥ 142 , selectable
- Body marks classified by specific exam types, and position adjustable
- Preset customization

4 Monitor Information

- Manufacturer logo
- Hospital name
- System date and time
- Probe and exam item
- MI and TI
- Operator
- Probe icon
- Patient ID, name, date of birth, gender and age
- Exam type icon
- Tissue temperature display (specified probe)
- Depth scale and focus position
- Image parameters
- Thumbnail image
- Clipboard
- Screen saver

5 Image Parameter

5.1 Overview

- Grayscale: 256 levels
- Transducer element: up to 256
- Audio: 0 - 100 levels adjustable

5.2 B Mode

- Gain: 0 - 255 adjustable
- Scan depth: ≥ 40 cm (different adjustable depth ranges for different probes)
- Compound imaging: off, 1, 2, 3 adjustable (e.g. 3C-A)
- HQ Scan: off, 1, 2, 3, 4 adjustable
- Frequency: 5 bands adjustable (fundamental wave: 5 bands; harmonic wave: 5 bands)
- Chroma: 1-13, 13 types selectable
- Adapt fusion imaging: 0-15, 16 types selectable
- μ -Scan: off, 1-8, 9 levels adjustable (e.g. 3C-A, different levels for different probes)

- Line density: 4 levels adjustable (Low/Med/High/SuperHigh)
- Persist: 0 - 60 (e.g. 6V3)
- Focus number: 16 (e.g. C1-6A, different focus number for different probes)
- Focus span: adjustable
- Dynamic range: 20 - 300 (e.g. C1-6A)
- Gray map: 1 - 15, 15 types selectable
- Power%: 1 - 100, 100 levels adjustable
- NSI: 0-254, 255 levels selectable
- Tissue acoustic index: 1400 - 1700, 31 levels adjustable
- TGC: 8 levels slider controls
- LGC: 8 bands
- Image inversion: left/right, up/down, rotation
- Sector width: adjustable
- B steer: 3 levels adjustable (linear array probe)
- Widescan: off, 1, 2
- Auto optimization: Gain and GSC
- Maximum frame rate: 1581f/s (e.g. S1-5, Cardiac-P)

5.3 M Mode

- Gain: 0 - 255 adjustable
- Chroma: 1 - 5, 5 types selectable
- Display format: H1/2, H1/4, V1/3, V1/2, V2/3, O1/4
- Scan speed: Min, Slow, Med, Fast, Max, 5 levels adjustable (e.g. Cardiac probe)
- Video invert: On/Off
- M process: Switch between average and peak values
- Power%: 30 - 100, 8 levels adjustable
- Color M: CFM, TDI

5.4 Anatomical M Mode

- Display 3 sample lines simultaneously
- Angle and position of sample lines: adjustable

5.5 CFM Mode

- Gain: 0 - 255 adjustable
- Power%: 0 - 100, 11 levels adjustable
- B reject: 0 - 255, 256 levels adjustable

- Size and position of color ROI: adjustable
- Image inversion: up/down, left/right
- Bright flow: Off, 1, 2, 3
- Invert: On/Off
- Frequency: 5 bands adjustable
- Wall filter: 10 - 750 adjustable (e.g. 12L-A)
- PRF: 0.5 - 8kHz adjustable (e.g. 3C-A)
- Line density: Low, Med, High, Highest, 4 levels adjustable
- Color map: 1-10, 10 types selectable
- Baseline: ± 15 , 31 levels adjustable
- Persist: 0 - 80 (e.g. 3C-A)
- ROI steer: 5 levels adjustable (linear array probes)
- ROI color: adjustable
- Auto optimization: ROI position and steer angle
- Dual live
- Maximum frame rate: 255f/s (S1-5, Cardiac)

5.6 PDI/DPDI Mode

- Power%: 0 - 100, 11 levels adjustable
- B reject: 0 - 255, 256 levels adjustable
- Persist: 0 - 80, 5 levels adjustable (e.g. 3C-A)
- Color map: 1 - 11, 11 types selectable
- Image inversion: up/down, left/right
- Bright flow: Off, 1, 2, 3
- Wall filter: 10 - 750 adjustable (e.g. 3C-A)

5.7 PW Mode

- Gain: 0 - 255 adjustable
- Display format: H1/2, H1/4, V1/3, V1/2, V2/3, O1/4
- Simultaneous mode (Triplex)
- PW sample volume: 0.5 - 24mm (e.g. 3C-A)
- PW sample position: adjustable
- Invert: On/Off
- Quick angle correction: 0°, 60° adjustable
- Angle correction range: 0 - 72° adjustable
- Steer angle: 5 levels adjustable (linear array probe)
- Auto trace: achievable in real-time mode and frozen mode
- Baseline: 17 levels adjustable
- Frequency: 5 levels adjustable

- Wall filter: 25 - 800 adjustable (e.g. 3C-A)
- PRF: 1 - 25kHz (e.g. C1-6)
- HPRF
- Velocity range: 0-27m/s (e.g. C1-6, PRF=25 kHz, $\theta=72^\circ$, frequency=2.2 MHz, the lowest baseline)
- Scan speed: Min, Slow, Med, Fast, Max
- Chroma: 1 - 5, 5 types adjustable
- Dynamic range: 11 - 20, 10 levels adjustable (e.g. C1-6)
- Auto Optimization: Baseline and PRF

5.8 SR Flow

- Gain: 0 - 255 adjustable
- Power%: 0 - 100, 11 levels adjustable
- B reject: 0 - 255, 256 levels adjustable
- Size and position of color ROI: adjustable
- Image inversion: up/down, left/right
- Bright flow: Off, 1, 2, 3
- Frequency: 5 bands adjustable
- PRF: 0.5-8kHz adjustable (e.g. 3C-A)
- Line density: 4 levels adjustable (Low/Med/High/Superhigh)
- Color map: 1-4, 4 types selectable
- Persist: 0 - 80 (e.g. C1-6)
- ROI steer: 5 levels adjustable (linear array probes)
- ROI color: adjustable
- Auto optimization: ROI position and steer angle
- Dual live
- Wall filter: 15-750
- Maximum frame rate: 255f/s

5.9 CW Mode

- Gain: 0 - 255 adjustable
- Display format: H1/2, H1/4, V1/3, V1/2, V2/3, O1/4
- CW sample position: adjustable
- Invert: On/Off
- Angle correction range: 0 - 72°
- Auto trace: achievable in real-time mode and frozen mode
- Baseline: 17 levels adjustable
- Wall filter: 25 - 800 levels adjustable

- PRF: 1 - 48kHz (e.g. S1-5)
- Velocity range: 0 - 40m/s (S1-5, PRF=48kHz, $\theta=60^\circ$, frequency=1.8 MHz, the lowest baseline)
- Scan speed: Min, Slow, Med, Fast, Max
- Chroma: 1 - 5, 5 types adjustable
- Dynamic range: 21-34, 14 levels adjustable

5.10 TDI Mode

- Tissue speed imaging and tissue power imaging
- Power%: 0 - 100, 11 levels adjustable
- B reject: 0 - 255, 256 levels adjustable
- Persist: 0 - 50, 5 levels adjustable (e.g. S1-5)
- Color map: 1 - 14 adjustable
- Image inversion: up, down, left, right
- Invert: On/Off
- Wall filter: 25 - 800 adjustable (e.g. S1-5)

5.11 TDI+PW Mode

- PRF: 1.0 - 25.0 kHz (e.g. S1-5)
- Velocity range: 0 - 17m/s (S1-5, PRF=25kHz, $\theta=72^\circ$, SVD=0 cm, the lowest baseline)

5.12 TDI+M Mode

- Gain: 0 - 255 adjustable
- Chroma: 1 - 5, 5 types selectable
- Display format: H1/2, H1/4, V1/3, V1/2, V2/3, O1/4
- Scan speed: Min, Slow, Med
- M process: switch between average and peak values
- Power%: 30 - 100, 8 levels adjustable

6 Advanced Features

6.1 Micro F

- Dual live
- Hide flow
- Image inversion: up/down, left/right
- Smooth: Off, 1, 2, 3, 4
- Bright flow: Off, 1, 2, 3
- Biopsy and biopsy calibration: available

6.2 Widescan Imaging

- Widescan: off, 1, 2 (linear array probe and convex array probe)

6.3 Zoom

- Zoom ratio: 0.7 - 10.0
- Scr-Zoom (one key full screen zoom)
- Pan-Zoom
- HD zoom

6.4 Customized Preset

- Customizable preset: user-defined parameters for different probes and exam types
- Preset order: adjustable
- Import or export presets
- Delete presets
- Overwrite presets

6.5 Freehand 3D

- Scan method: sector scan, parallel scan
- Display format: single display, dual-split display, quad-split display
- Slice: A, B, C, 3D
- Rotate image along X, Y or Z axis
- Up/Down: move the image up/down
- Left/Right: move the image left/right
- Direction: top, bottom, left, right, front, back
- 3D orientation: 0°, 90°, 180°, 270°
- Reset: default settings, sweep angle, viewing angle, direction
- Render mode: Surface, Grad. Light, Skeleton, Transp. Min, X-Ray, S-Depth, S-Live
- Auto rotation: 0°, 45°, 90°, 180°, 270°, 360°
- 3D Frame: On/Off
- Edit ROI: On/Off
- Adjust light: On/Off (S-Live)
- Trackball (Rotate highlighted): Rotate, Z Rotate
- Threshold: 0 - 100, 1 each step
- Contrast: 0 - 100, 1 each step
- Transparency: 0 - 100, 1 each step
- Brightness: 0 - 100, 1 each step
- Smoothness: 0 - 30, 1 each step
- Light position: 0 - 9, 1 each step

- B Chroma: 1 - 13, 1 each step
- 3D Chroma: Off, 1- 14 adjustable, 1 each step
- Distance in parallel scan mode: 10 -200, 10 each step (range depends on number of scanning slices)
- Z axis angle in sector scan mode: 5°- 170°, 5° each step
- Edit: trace, box, eraser
- Display (C-Plane): AB, AC, BC, ABC
- M-Slice
 - Display: 1*2, 2*2, 3*4, 3*3, 4*4, 5*5
 - Slice distance: 0.5 - 10.0 adjustable, 0.5 each step
 - Slice number: 3 - 29 adjustable, 2 each step
 - Single slice magnification
- AVC Follicle

6.6 Static 3D/4D

- Display format: single display, dual-split display, quad-split display
- Slice: A, B, C, 3D
- Rotate image along X, Y or Z axis
- Up/Down: move the image up/down
- Left/Right: move the image left/right
- Direction: top, bottom, left, right, front, back
- 3D orientation: 0°, 90°, 180°, 270°
- Reset: default settings, sweep angle, viewing angle, direction
- Render mode: Surface, Grad. Light, Skeleton, Transp. Min, X-Ray, S-Depth, S-Live
- Auto rotation: 0°, 45°, 90°, 180°, 270°, 360°
- 3D Frame: On/Off
- Image quality: Low, Med1, Med2, High1, High2, Max
- Sweep angle: 10°-120° (VE9-5) / 5°-75° (VC6-2) / 5°-85° (VC2-9), 5° each step
- Stability: On/Off
- Focus: can be moved and adjusted according to ROI
- Edit ROI: On/Off
- Auto face: On/Off
- Adjust light: On/Off (S-Live)

- VolPre: user can return to pre-activated mode from activated mode
- Cine loop: different adjustment range for different size of volume data
- First frame: To first frame
- Last frame: To last frame
- Auto play: On/Off
- Set first frame: set the saved first frame
- Set last frame: set the saved last frame
- Frame by frame: select the current frame
- Cine speed: adjust the auto play speed
- Trackball (Rotate highlighted): Rotate, Z Rotate
- Threshold: 0 - 100, 1 each step
- Contrast: 0 - 100, 1 each step
- Transparency: 0 - 100, 1 each step
- Brightness: 0 - 100, 1 each step
- Smoothness: 0 - 30, 1 each step
- Light Position: 0 - 9, 1 each step (light position can also be set at any place by rotating the trackball)
- 3D Chroma: Off, 1- 14 adjustable, 1 each step
- B Chroma: 1 - 13, 1 each step
- 2D μ -Scan: Off, 1-19, 20 levels adjustable
- 3D μ -Scan: Off, 1, 2, 3, 4, 5, 6 levels adjustable
- Edit: trace, box, eraser
- Display (C-Plane): AB, AC, BC, ABC
- M-Slice
 - Display: 1*2, 2*2, 3*4, 3*3, 4*4, 5*5
 - Slice distance: 0.5 - 10.0 adjustable, 0.5 each step
 - Slice number: 3 - 29 adjustable, 2 each step
 - Single slice magnification
- AVC Follicle
- Maximum frame rate: 36.0 f/s (VE9-5, 4D)
- Direction: top, bottom, left, right, front, back
- 3D orientation: 0°, 90°, 180°, 270°
- Reset: default settings, sweep angle, viewing angle, direction
- Render mode (three types).
 - Color render mode: Surface, X-ray, MIP, Grad, Light
 - Glass render mode: Surface + Surface, Surface + MIP
 - Gray render mode: Surface, Grad, Light
- Auto rotation: 0°, 45°, 90°, 180°, 270°, 360°
- 3D Frame: On/Off
- Image quality: Low, Med1, Med2, High1, High2, Max
- Sweep angle: 10° - 120° (VE9-5) / 5° - 75° (VC6-2) / 5° - 85° (VC2-9), 5° each step
- Edit ROI: On/Off
- Color off: On/Off, available only in Color and Glass render mode
- VolPre: user can return to pre-activated mode from activated mode
- Trackball (Rotate highlighted): Rotate, Z Rotate
- Color threshold: 0 - 127, 1 each step, adjustable only in Color and Glass render mode
- Color map: 1 - 10, 1 each step, adjustable only in Color and Glass render mode
- Gray/Color: 0%/100% - 100%/0%, 1% each step, adjustable only in Glass render mode
- Mix: 0%/100% - 100%/0%, 1% each step
- Threshold: 0 - 100, 1 each step, adjustable only in Glass and Gray render mode
- Contrast: 0 - 100, 1 each step, adjustable only in Glass and Gray render mode
- Transparency: 0 - 100, 1 each step
- Brightness: 0 - 100, 1 each step
- Smoothness: 0 - 30, 1 each step
- 3D Chroma: Off, 1-14 adjustable, 1 each step, adjustable only in Glass and Gray render mode
- B Chroma: 1 - 13, 1 each step
- Edit: trace, box, eraser
- Cut part: Color, Gray + Color, Gray,

6.7 CFM 3D

- Display format: single display, dual-split display, quad-split display
- Slice: A, B, C, 3D
- Rotate image along X, Y or Z axis
- Up/Down: move the image up/down
- Left/Right: move the image left/right

- adjustable only in Glass render mode
- Display (C-Plane): AB, AC, BC, ABC
- M-Slice
 - Display: 1*2, 2*2, 3*4, 3*3, 4*4, 5*5
 - Slice distance: 0.5 - 10.0 adjustable, 0.5 each step
 - Slice number: 3 - 29 adjustable, 2 each step
 - Single slice magnification
- STIC CFM

6.8 PDI 3D

- Display format: single display, dual-split display, quad-split display
- Slice: A, B, C, 3D
- Rotate image along X, Y or Z axis
- Up/Down: move the image up/down
- Left/Right: move the image left/right
- Direction: top, bottom, left, right, front, back
- 3D orientation: 0°, 90°, 180°, 270°
- Reset: default settings, sweep angle, viewing angle, direction
- Render mode (three types)
 - Color render mode: Surface, Grad. Light
 - Glass render mode: Surface + Surface, Surface + MIP
 - Gray render mode: Surface, Grad. Light
- Auto rotation: 0°, 45°, 90°, 180°, 270°, 360°
- 3D Frame: On/Off
- Image quality: Low, Med1, Med2, High1, High2, Max
- Sweep angle: 10° - 120° (VE9-5) / 5° - 75° (VC6-2) / 5° - 85° (VC2-9), 5° each step
- Edit ROI: On/Off
- Color off: On/Off, adjustable only in Color and Glass render mode
- VolPre: pre-activate return available
- Trackball (Rotate highlighted): Rotate, Z Rotate
- Color threshold: 0 - 255, 1 each step, adjustable only in Color and Glass render mode
- Color map: 1 - 7, 1 each step, adjustable only in PDI 3D and Glass render mode
- Gray/Color: 0%/100% - 100%/0%, 1%

- each step, adjustable only in Glass render mode
- Mix: 0%/100% - 100%/0%, 1% each step
- Threshold: 0 - 100, 1 each step, adjustable only in Glass and Gray render mode
- Contrast: 0 - 100, 1 each step, adjustable only in Glass and Gray render mode
- Transparency: 0 - 100, 1 each step
- Brightness: 0 - 100, 1 each step
- Smoothness: 0 - 30, 1 each step
- 3D Chroma: Off, 1 - 14 adjustable, 1 each step, adjustable only in Glass and Gray render mode
- B Chroma: 1 - 13, 1 each step
- Edit: trace, box, eraser
- Cut part: Color, Gray + Color, Gray, adjustable only in Glass render mode
- Display (C-Plane): AB, AC, BC, ABC
- M-Slice
 - Display: 1*2, 2*2, 3*4, 3*3, 4*4, 5*5
 - Slice distance: 0.5 - 10.0 adjustable, 0.5 each step
 - Slice number: 3 - 29 adjustable, 2 each step
 - Single slice magnification
- STIC PDI

6.9 SR Flow 3D

- Display format: single display, dual-split display, quad-split display
- Slice: A, B, C, 3D
- Rotate image along X, Y or Z axis
- Up/Down: move the image up/down
- Left/Right: move the image left/right
- Direction: top, bottom, left, right, front, back
- 3D orientation: 0°, 90°, 180°, 270°
- Reset: default settings, sweep angle, viewing angle, direction
- Render mode (three types)
 - Color render mode: Surface, X-ray, MIP, Grad. Light
 - Glass render mode: Surface + Surface, Surface + MIP
 - Gray render mode: Surface, Grad. Light
- Auto rotation: 0°, 45°, 90°, 180°, 270°, 360°

- 3D Frame: On/Off
- Image quality: Low, Med1, Med2, High1, High2, Max
- Sweep angle: 10° - 120° (VE9-5) / 5° - 75° (VC6-2) / 5° - 85° (VC2-9), 5° each step
- Edit ROI: On/Off
- Color off: On/Off, available only in Color and Glass render mode
- VolPre: user can return to pre-activated mode from activated mode
- Trackball (Rotate highlighted): Rotate, Z Rotate
- Color threshold: 0 - 127, 1 each step, adjustable only in Color and Glass render mode
- Color map: 1 - 4 (VE9-5), 1 - 7 (VC2-9, VC6-2), 1 each step, adjustable only in Color and Glass render mode
- Gray/Color: 0%/100% - 100%/0%, 1% each step, adjustable only in Glass render mode
- Mix: 0%/100% - 100%/0%, 1% each step
- B mode threshold: 0 - 100, 1 each step, adjustable only in Glass and Gray render mode
- Contrast: 0 - 100, 1 each step, adjustable only in Glass and Gray render mode
- Transparency: 0 - 100, 1 each step
- Brightness: 0 - 100, 1 each step
- Smoothness: 0 - 30, 1 each step
- 3D Chroma: Off, 1 - 14 adjustable, 1 each step, adjustable only in Glass and Gray render mode
- B Chroma: 1 - 13, 1 each step
- Edit: trace, box, eraser
- Cut part: Color, Gray + Color, Gray, adjustable only in Glass render mode
- Display (C-Plane): AB, AC, BC, ABC
- M-Slice
 - Display: 1*2, 2*2, 3*4, 3*3, 4*4, 5*5
 - Slice distance: 0.5 - 10.0 adjustable, 0.5 each step
 - Slice number: 3 - 29 adjustable, 2 each step
 - Single slice magnification

- STIC SR Flow

6.10 STIC

- Display format: single display, dual-split display, quad-split display
- Slice: A, B, C, 3D
- Rotate image along X, Y or Z axis
- Up/Down: move the image up/down
- Left/Right: move the image left/right
- Direction: top, bottom, left, right, front, back
- 3D orientation: 0°, 90°, 180°, 270°
- Reset: default settings, sweep angle, viewing angle, direction
- Render mode: Surface, Grad. Light, Skeleton, Transp. Min, X-Ray, S-Depth, S-Live
- Auto rotation: 0°, 45°, 90°, 180°, 270°, 360°
- 3D Frame: On/Off
- Scan time: 7.5s, 10s, 12.5s, 15s, 2.5s each step
- Sweep angle: 10° - 90° (VE9-5) / 15° - 60° (VC6-2) / 15° - 60° (VC2-9), 5° each step
- Edit ROI: On/Off
- Adjust light: On/Off (S-Live)
- Cine loop: different adjustment range for different size of volume data
- Auto play: On/Off
- Frame by frame: select the current frame
- Cine speed: adjust the auto play speed
- Trackball (Rotate highlighted): Rotate, Z Rotate
- Threshold: 0 - 100, 1 each step
- Contrast: 0 - 100, 1 each step
- Transparency: 0 - 100, 1 each step
- Brightness: 0 - 100, 1 each step
- Smoothness: 0 - 30, 1 each step
- Light position: 0 - 9, 1 each step
- 3D Chroma: Off, 1 -14 adjustable, 1 each step
- B Chroma: 1 - 13, 1 each step
- 2D μ -Scan: Off, 1-19, 20 levels adjustable
- 3D μ -Scan: Off, 1, 2, 3, 4, 5, 6 levels adjustable
- Edit: trace, box, eraser
- Display (C-Plane): AB, AC, BC, ABC

- M-Slice
 - Display: 1*2, 2*2, 3*4, 3*3, 4*4, 5*5
 - Slice distance: 0.5 - 10.0 adjustable, 0.5 each step
 - Slice number: 3 - 29 adjustable, 2 each step
 - Single slice magnification

6.11 FreeVue

- Line type: Line, Curve, Poly Line, Trace
- Line number: One, Two, Three
- View mode: Acture, Project
- Viewing direction: Left, right, top, bottom
- ICON switch: control the display of image marks
- View Rot: control the rotation of icon
- Contrast 3D/4D

6.12 Volume Contrast Imaging

- VCI: On/Off
- Render mode: Surface, X-Ray, Skeleton, Transp.Min, S-Depth
- Thickness: 1mm - 20mm, 1 each step
- Threshold: 0 - 100, 1 each step, adjustable only in Surface and S-Depth render modes
- Contrast: 0 - 100, 1 each step
- Transparency: 0 - 100, 1 each step
- Brightness: 0 - 100, 1 each step
- 2D μ -Scan: Off, 1-19, 20 levels adjustable
- 3D Chroma: Off, 1-14, 15 levels adjustable, 1 each step
- 3D GSC: 1-15 adjustable, 1 each step
- Reconstruction direction: acquire the VCI volume data from the inside or outside of the line (adjustable only in FreeVue)

6.13 S-Spine

- Automatic adjustment of ROI
- Automatic identification and imaging of fetal spine

6.14 Vocal

- Contour tracing
- Segmentation method: Manual, Sphere
- Rotation step: 6°, 9°, 15°, 30°
- Volume Measurement: available, inside,

- outside, shell, reference
- Contour editing: available
- Shell mode: off, inside, outside, symm.
- Contour render: available
- Contour render: skin or wire mesh
- Contour light: adjustable
- Contour color: 1 - 5 level, 1 each step
- Thresh vol: Low, High, Threshold volume
- Threshold: 0 - 100, 1 each step
- Shell volume render: available
- Histogram display: MG, V1, F1, VFI

6.15 Panoramic Imaging

- B mode panoramic imaging
- Color panoramic imaging (CFM/PDI), only available on linear array probe
- Rotation: -180° to 180°
- Zoom: 8.0 times
- Maximum available length: 1000mm
- Chroma: 1-13
- Gray map: 1 - 15
- Image scale: On/Off
- Full view

6.16 Biopsy Guide Function

- Biopsy line angle: adjustable
- Biopsy line dot size: adjustable
- Biopsy depth: adjustable
- Biopsy line angle calibration
- Biopsy line offset calibration
- Biopsy line calibration parameter storage and load default
- User-defined biopsy line angle

6.17 Vis-Needle

- Steer angle:
 - Left: 20° to 50°, 5° each step, 7 levels adjustable
 - Right: -20° to -50°, 5° each step, 7 levels adjustable
- Direction: left and right, 2 levels adjustable
- Dual-split display

6.18 C-xlasto (Compression Elastography)

- Image inversion: up/down, left/right
- Display format: single display and dual-split display
- Map display: independent adjustment of left and right map
- Depth adjustment
- B image parameters: adjustable
- TGC: adjustable
- User-defined preset of C-xlasto: available
- Strain map left: 1 - 7, 1 each step
- Strain map right: 0 - 7, 1 each step
- Frequency: 5 levels adjustable
- Strain process: 0 - 6, 7 levels available
- Contrast: 0.02 - 2.00, 0.01 each step
- Transparency: 0.10 - 1.00, 0.02 each step
- Persist: 0.02 - 0.98, 0.02 each step

6.19 Contrast Imaging

- Real-time retrospective storage and prospective storage
- Display format: single (B), dual (2B)
- Image inversion: up/down, left/right
- Biopsy and biopsy calibration: available
- Two timers
- Flash power%: 1 - 100, 1 each step
- Flash time: 0.1s - 10.0s, 0.1s - 15.0s (VE9-5)
- Dynamic range: 20 - 280, 14 levels adjustable
- Power: 1% - 100%, 100 levels adjustable
- Gray map: 1 - 15, 15 types adjustable
- Chroma: 1 - 15, 15 types adjustable
- μ -Scan: off, 1 - 5, 6 levels adjustable
- Persist: 0 - 60, 7 levels adjustable
- Sector width: adjustable
- TIC quantitative analysis
 - Time Intensity Curve (TIC) analysis
 - ROI outline: Trace/Ellipse
 - Trace: can be deleted and cleared
 - Curve display: available
 - Parameter display: available
 - Max. ROI: 8
 - Four compound curves: Bolus WIWO, General, Wash In, Wash Out
 - Compound curve: can be hidden
 - Cine speed: 7 levels adjustable

- Contrast agent parameter switching: available
- MFI
- MFI Time
- Mix Mode
- MFI Time editing and measurement: available
- Contrast HFR: available

6.20 Stress Echo

- Protocol: user-defined or selectable
- Acquisition of cardiac sections in different stress levels in terms of selected protocol for advanced and flexible stress echo examination
- Available on phased array probe, under Cardiac preset
- Provides exercise and pharmacological protocol templates
- Continuous acquisition of sections in the template
- Acquired sections selectable for the exam
- Supports comparison among the acquired sections
- Wall motion scoring (bull's eye) and reporting
- Available for suspending the stress echo during scan

6.21 G-MQA

- Section type: A2C/A3C/A4C/PLAX/PSAX A/PSAX M/PSAX B
- Trace point: editable
- Motion direction:
 - Long axis: Longitudinal, Radial
 - Short axis: Radial, Rotation, Circumference
- Multiple curve types: Strain, Strain Rate, Velocity, Displacement, Volume
- Bull's eye display
- Peak time display
- Cardiac valve open-close time indication
- Time measurement

6.22 R-MQA

- Trace: user-defined and deletable

- Max. ROI: 20
- Four curve types: Strain, Strain Rate, Velocity, Displacement
- Peak time display
- Cardiac valve open-close time indication
- Time measurement

6.23 Sono-Help

- Applications: Liver, Kidney, Spleen, Biliary system, Uterine adnexa, Obstetrics, Cardiac, Artery and Vein, Thyroid, Breast, Prostate and testicle
- Available for 82 standard scan planes
- Available for probe position, anatomic diagram and ultrasound reference image display
- User-defined key: available

6.24 Sono Assistant

- Available in vascular and obstetrics applications
- Auto workflow protocol
- Templates are user-configurable
- Provides reference sections for carotid, LEA, LEV(DVT) and LEV(Reflux) in vascular
- Provides reference sections for early pregnancy, NT, level I, level II and level III screening in obstetrics
- Ultrasound image display of the standard plane for reference
- Displays unfinished scanning sections in the exam
- Supports imaging mode: B/B+Color/B+PW/B+Color+PW/B+CW/B+Color+CW/B+M/B+Color+M

6.25 Sono-Drop

- On-site wireless image transmission
- An interactive app that lets you transfer clinical image from SonoScape ultrasound system to a smart device
- Communication should be established by scanning the encrypted QR code.
- Transfer images or clips from system to mobile terminal through WiFi

7 Measurement/Analysis and Report

7.1 Measurement settings

- BSA setting: Eastern, Western
- Cross cursor size: Small, Medium, Large
- Measure line size: Small, Medium, Large
- Distance dash line display: On/Off
- Velocity cross line display: On/Off
- Ellipse cross line display: On/Off
- Volume flow method: TAmear, TAmear
- Volume flow compensation with TAmear: 0.5, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00
- Line ID display: On/Off
- Keep result window: On/Off
- Result font size: Small, Medium, Large
- Result font color: White, Yellow
- Result position: Top Right, Top Left, Bottom Left and Bottom Right adjustable in 2D or M+D mode

7.2 Basic Measurement Package

- Obstetrics measurement package
- Small parts measurement package
- Gynecology measurement package
- Vascular measurement package
- Abdominal measurement package
- Cardiac measurement package
- Urology measurement package
- Pediatrics measurement package
- Pelvic floor measurement package

7.3 Report

- Application-specific measurement report
 - ✓ Fetal growth curves
 - ✓ Fetus anatomy evaluation
 - ✓ Fetus compare (four fetuses)
 - ✓ Gynecological pelvic floor report
 - ✓ IOTA
 - ✓ Follicle curve
 - ✓ Gynecological anatomy evaluation
 - ✓ BI-RADS
 - ✓ TI-RADS
 - ✓ Stress echo test and bull's eye

- Measurement values: editable
- Measurement results process method: selectable
- Image Insertion
- Report preview
- Comment edit: available
- DICOM send: available
- Report logo (170x60Pixel, bmp): replaceable
- Font size and color settings
- Background color settings
- Display item settings
- Export format: PDF, TXT, RTF, HTML

7.4 S-Fetus

- S-Fetus basic (basic edition)
- S-Fetus adv. (advanced edition)
- S-Fetus (meas.)
- Supported planes: Transthalamic Plane (TTP), Transcerebellar Plane (TCP), Transventricular Plane (TVP), Coronal Nose & Lips, Transverse Orbits, Profile and Nasal Bone, Four Chambers View (A4C), Abdominal Circumference, Transverse Kidneys, Umbilical Cord Insertion, Bladder and Umbilical Arteries, Femur, Sagittal Spine-Cervical & Thoracic Level, Sagittal Spine-Lumbar & Sacral Level, Placenta, Amniotic Fluid
- Shortcut key: Auto key and user-defined key
- Quality control of section identification

7.5 S-PF

- S-Pelvic (2D): Auto anterior compartment evaluation
- S-Pelvic (3D): Auto levator hiatus evaluation
- Rest and Valsalva statuses in 2D mode, Rest, Valsalva and Contraction statuses in 3D mode
- Two reference lines: Screen horizontal line, 135° to the axis of SP

7.6 S-Endo/S-Follicle

- S-Endometrium: Auto endometrium

recognition and measurement

- S-Follicle: Auto 2D follicle recognition and measurement

7.7 S-Hip

- S-Hip(acq.)
- S-Hip(meas.)
- α angle, β angle, and FHC
- Rotation 270°, Ger1; Rotation 90°, Ger2
- Measurement results

7.8 Auto Measurement

- Auto IMT
- Auto OB
plus (NT/AC/HC/HL/FL/BPD/Cereb/Vp/C
TAR/CTDR/Cardiac axis/AFI/PL)
- Auto Bladder Volume Measurement
- Auto EF
- S-Follicle
- AVC Follicle
- S-Endo

8 Storage and Data Management

8.1 Storage

- Hard disc storage: 2T
- 2D cine storage time setting:
 - ✓ Prospective storage: 1 - 20s or 1-20 cardiac cycle
 - ✓ Retrospective storage: 1 - 600s or 1-20 cardiac cycle
 - ✓ Freeze storage: 1 - 120s
- 4D cine storage time setting:
 - ✓ Prospective storage: 1 - 600s
 - ✓ Retrospective storage: 1 - 50s
- Directly store to USB drive
- Prospective storage for contrast imaging

8.2 Data Management

- Image, video and report sharing service (Samba)
- Export data to USB drive or DVD
- Export format:
 - ✓ System format
 - ✓ PC format
 - ✓ Image format: BMP, JPG, TIF

- ✓ Cine format: AVI, WMV, MP4
- ✓ Report format: PDF, TXT, HTML, RTF
- ✓ DICOM format
- ✓ DICOMDIR format
- Clipboard: thumbnail display, delete, export
- Create exam, activate exam, resume suspended exam
- Query/Retrieve service
- Review current exam and history exam
- Post-processing and post-measurement
- Backstage storage: quick switch of DICOM cine

8.3 Cine Review

- Cine review: frame by frame manual play and auto play with adjustable speed
- One keystroke reviews the first frame or last frame
- Auto play: can be activated/inactivated by using trackball

9 Connectivity

9.1 I/O Port

- USB port:
 - ✓ USB 3.0: 2
 - ✓ USB 2.0: 4 (one USB port for engineering update)
- Video output port: 8
 - ✓ VGA
 - ✓ RGB
 - ✓ S-VIDEO OUT
 - ✓ S-VIDEO IN
 - ✓ VIDEO OUT
 - ✓ VIDEO IN
 - ✓ DVI OUT
 - ✓ HDMI OUT
- Audio input/output port:
 - ✓ AUDIO IN
 - ✓ AUDIO OUT
- Foot switch input: 1
- Ethernet port: 1
- Video print port: 1
- Physiological signal input port: 1

9.2 Video Output Settings

- VIDEO/S-VIDEO (TV-NTSC , TV-PAL)
- VGA/RGB (4:3)
- VGA/RGB (16:9)
- HDMI/DVI (4:3)
- HDMI/DVI (16:9)

9.3 Network Connection

- Local network
 - ✓ Local network: On/Off
 - ✓ DHCP or static IP
 - ✓ Static IP: IP, netmask and default gateway settings
 - ✓ MAC address check
 - ✓ Advance: speed (10M, 100M, 1000M, UnKnown!), duplex (Semi Duplex, Full Duplex, UnKnown!)
 - ✓ Speed and duplex search and settings
 - ✓ Ping IP Address
- Wireless network
 - ✓ Wireless network: On/Off
 - ✓ Authentication method: Open, WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA-EAP
 - ✓ DHCP or static IP
 - ✓ Static IP: IP, netmask and default gateway settings
 - ✓ MAC address check
 - ✓ WIFI connection, disconnection, refresh, advanced configuration and network adding
 - ✓ Ultrasound hotspot
 - ✓ Switch between ultrasound hotspot and WIFI

9.4 DICOM 3.0

- DICOM storage
- DICOM structured report
 - ✓ Gynecology structured report
 - ✓ Obstetrics structured report
 - ✓ Cardiology structured report
 - ✓ Vascular structured report
- DICOM storage commitment
- DICOM Worklist
- DICOM MPPS
- DICOM print

- DICOM Q/R list

10 Probe

NOTE: For the following probes that support widescan, bilateral extension is also supported.

10.1 Convex Array Probe

- C1-6

- ✓ Application: Abdomen, OB/Gynecology
- ✓ Frequency range: 1.0-8.0MHz
- ✓ Central frequency: 3.2MHz
- ✓ Curvature radius: 50mm
- ✓ Transducer element: 160
- ✓ Field of view: 64°
- ✓ Widescan (unilateral, 2 levels adjustable): 14°/18°
- ✓ Depth: ≥40cm
- ✓ Acoustic lens: 60mm×16mm
- ✓ Biopsy bracket: NGBC1-6, 15°/24°, sterilizable

- 3C-A

- ✓ Application: Abdomen, OB/Gynecology
- ✓ Frequency range: 1.0-7.0MHz
- ✓ Central frequency: 3.2MHz
- ✓ Curvature radius: 50mm
- ✓ Transducer element: 128
- ✓ Field of view: 60°
- ✓ Widescan (unilateral, 2 levels adjustable): 13°/17°
- ✓ Depth: ≥40cm
- ✓ Acoustic lens: 60mm×18mm
- ✓ Biopsy bracket: NGB3C-A, 12°/16.5°/22.5°/33.5°, sterilizable

- C2-9

- ✓ Application: Abdomen, OB/Gynecology
- ✓ Frequency range: 3.0-10.0MHz
- ✓ Central frequency: 5MHz
- ✓ Curvature radius: 43mm
- ✓ Transducer element: 192
- ✓ Field of view: 64°
- ✓ Widescan (unilateral, 2 levels adjustable): 13°/17°
- ✓ Depth: ≥30cm
- ✓ Acoustic lens: 53mm×13mm

- 6V3

- ✓ Application: Gynecology, Urology
- ✓ Frequency range: 3.0-15.0MHz
- ✓ Central frequency: 6.0 MHz
- ✓ Curvature radius: 10.3mm
- ✓ Transducer element: 192
- ✓ Field of view: 198°
- ✓ Widescan (unilateral, 2 levels adjustable): 14°/18°
- ✓ Depth: ≥16 cm
- ✓ Acoustic lens: 41mm×10mm
- ✓ Biopsy bracket: NGB6V3, 0°, sterilizable
- ✓ Temperature control

- 6V7

- ✓ Application: Gynecology, Urology
- ✓ Frequency range: 3.0-15.0MHz
- ✓ Central frequency: 5.7 MHz
- ✓ Curvature radius: 10.3mm
- ✓ Transducer element: 192
- ✓ Field of view: 198°
- ✓ Widescan (unilateral, 2 levels adjustable): 11°/15°
- ✓ Depth: ≥16 cm
- ✓ Acoustic lens: 41mm×10mm
- ✓ Biopsy bracket: NGB6V7, 15°, sterilizable
- ✓ Temperature control

- 6V3A

- ✓ Application: Gynecology, Urology
- ✓ Frequency range: 3.0-15.0MHz
- ✓ Central frequency: 6MHz
- ✓ Curvature radius: 8mm
- ✓ Transducer element: 128
- ✓ Field of view: 147°
- ✓ Depth: ≥12cm
- ✓ Acoustic lens: 26mm×10mm

- C613

- ✓ Application: Abdomen, Cardiology, Pediatric Cardiology
- ✓ Frequency range: 4.0-13.0MHz
- ✓ Central frequency: 6.0 MHz
- ✓ Curvature radius: 14mm
- ✓ Transducer element: 128
- ✓ Field of view: 90°

- ✓ Widescan (unilateral, 2 levels adjustable): 14°/18°
- ✓ Depth: ≥16 cm
- ✓ Acoustic lens: 30mm×10mm
- ✓ Biopsy bracket: NGBC613, 12°/18°/30°, sterilizable

- C322

- ✓ Application: Abdomen
- ✓ Frequency range: 2.0-7.0MHz
- ✓ Central frequency: 3.5MHz
- ✓ Curvature radius: 20mm
- ✓ Transducer element: 128
- ✓ Field of view: 76°
- ✓ Widescan (unilateral, 2 levels adjustable): 12°/16°
- ✓ Depth: ≥24cm
- ✓ Acoustic lens: 32mm×11mm
- ✓ Biopsy bracket: NGBC322, 5°/25°, sterilizable

- BCL10-5

- ✓ Application: Urology
- ✓ Frequency range: 4.0-16.0MHz
- ✓ Biopsy bracket: NGBBCL10-5, 90°; biopsy depth (linear array): 10mm-50mm, sterilizable

Convex array:

- ✓ Central frequency: 6MHz
- ✓ Curvature radius: 10mm
- ✓ Transducer element: 192
- ✓ Field of view: 200°
- ✓ Depth: ≥15cm
- ✓ Acoustic lens: 40mm×10mm

Linear array:

- ✓ Central frequency: 7.5MHz
- ✓ Transducer element: 192
- ✓ Width of view: 60mm
- ✓ Depth: ≥10cm
- ✓ Acoustic lens: 63mm×9mm

- BCC9-5

- ✓ Application: Urology
- ✓ Frequency range: 3.0-15.0MHz
- ✓ Biopsy bracket: NGBBCC9-5, sterilizable

Convex array:

- ✓ Central frequency: 6MHz
- ✓ Curvature radius: 10mm
- ✓ Transducer element: 128
- ✓ Field of view: 140°
- ✓ Depth: ≥15cm
- ✓ Acoustic lens: 26mm×10mm

10.2 Linear Array Probe

- 12L-A

- ✓ Application: Peripheral Vascular, Superficial, and Small parts
- ✓ Frequency range: 3.0-17.0MHz
- ✓ Central frequency: 8.0 MHz
- ✓ Transducer element: 256
- ✓ Width of view: 51mm
- ✓ Depth: ≥11cm
- ✓ B steer: 0°/±10°, 3 levels
- ✓ ROI steer/sample line steer: 0°/±16°/±20° (some modes: 0°/±12°/±20°)
- ✓ Trapezoid imaging (unilateral, 2 levels adjustable): 14°/17°
- ✓ Acoustic lens: 55mm×8mm
- ✓ Biopsy bracket: NGB12L-A, 44°/53°/64°, sterilizable

- 12L-B

- ✓ Application: Peripheral Vascular, Superficial, and Small parts
- ✓ Frequency range: 3.0-17.0MHz
- ✓ Central frequency: 8.0 MHz
- ✓ Transducer element: 192
- ✓ Width of view: 38mm
- ✓ Depth: ≥11cm
- ✓ B steer: 0°/±10°, 3 levels
- ✓ ROI steer/sample line steer: 0°/±16°/±20° (some modes: 0°/±12°/±20°)
- ✓ Trapezoid imaging (unilateral, 2 levels adjustable): 14°/17°
- ✓ Acoustic lens: 42mm×7mm
- ✓ Biopsy bracket: NGB12L-B, 39°/48°/60°, sterilizable

- 9L-A

- ✓ Application: Peripheral Vascular, Superficial, and Small parts
- ✓ Frequency range: 2.0-13.0MHz
- ✓ Central frequency: 6.0 MHz

- ✓ Transducer element: 128
- ✓ Width of view: 35mm
- ✓ Depth: ≥ 11 cm
- ✓ B steer: $0^\circ/\pm 8^\circ$, 3 levels
- ✓ ROI steer/sample line steer:
 $0^\circ/\pm 16^\circ/\pm 20^\circ$ (some modes:
 $0^\circ/\pm 12^\circ/\pm 20^\circ$)
- ✓ Trapezoid imaging (unilateral, 2 levels adjustable): $12^\circ/18^\circ$
- ✓ Acoustic lens: 42mm $\times$ 9mm
- ✓ Biopsy bracket: NGB9L-A,
 $38^\circ/47^\circ/59^\circ$, sterilizable

10.3 Phased Array Probe

- S1-5
 - ✓ Application: Cardiology
 - ✓ Frequency range: 1.0-7.0MHz
 - ✓ Central frequency: 2.7 MHz
 - ✓ Transducer element: 80
 - ✓ Field of view: 90°
 - ✓ Depth: ≥ 30 cm
 - ✓ Acoustic lens: 25mm $\times$ 16mm
 - ✓ Biopsy bracket: NGBS1-5,
 $11.5^\circ/18^\circ/28^\circ$, sterilizable
- 4P-A
 - ✓ Application: Cardiology
 - ✓ Frequency range: 1.0-6.0MHz
 - ✓ Central frequency: 2.7MHz
 - ✓ Transducer element: 80
 - ✓ Field of view: 90°
 - ✓ Depth: ≥ 30 cm
 - ✓ Acoustic lens: 25mm $\times$ 16mm
 - ✓ Biopsy bracket: NGB4P-A,
 $14^\circ/26^\circ$, sterilizable
- 7P-A
 - ✓ Application: Pediatric Cardiology
 - ✓ Frequency range: 2.0-9.0MHz
 - ✓ Central frequency: 4.5MHz
 - ✓ Transducer element: 96
 - ✓ Field of view: 90°
 - ✓ Depth: ≥ 23 cm
 - ✓ Acoustic lens: 21mm $\times$ 12mm
- 8P1
 - ✓ Application: Neonatal Cardiology
 - ✓ Frequency range: 4.0-12.0MHz

- ✓ Central frequency: 6.5MHz
- ✓ Transducer element: 96
- ✓ Field of view: 90°
- ✓ Depth: ≥ 16 cm
- ✓ Acoustic lens: 14mm $\times$ 10mm

10.4 Volume Probe

- VC6-2
 - ✓ Application: Abdomen, Obstetrics
 - ✓ Frequency range: 1.0-7.0MHz
 - ✓ Central frequency: 3.75MHz
 - ✓ Curvature radius: 40mm
 - ✓ Field of view: 68°
 - ✓ Widescan: $12^\circ/16^\circ$
 - ✓ Transducer element: 128
 - ✓ Depth: ≥ 30 cm
 - ✓ Acoustic window: 150mm $\times$ 86mm
- VE9-5
 - ✓ Application: OB/Gynecology
 - ✓ Frequency range: 2.0-13.0MHz
 - ✓ Central frequency: 6.0MHz
 - ✓ Curvature radius: 10.3mm
 - ✓ Field of view: 182°
 - ✓ Widescan (unilateral, 2 levels adjustable):
 $11^\circ/15^\circ$
 - ✓ Transducer element: 180
 - ✓ Depth: ≥ 15 cm
 - ✓ Acoustic window: 39mm $\times$ 39mm

10.5 Specialty Probe

- 10I2
 - ✓ Application: Peripheral Vascular,
Superficial, Small parts and
Intraoperative
 - ✓ Frequency range: 4.0-16.0MHz
 - ✓ Central frequency: 7.5MHz
 - ✓ Width of view: 25mm
 - ✓ Transducer element: 96
 - ✓ Depth: ≥ 11 cm
 - ✓ ROI steer/sample line steer: $0^\circ/\pm 16^\circ/\pm 20^\circ$
(some modes: $0^\circ/\pm 12^\circ/\pm 20^\circ$)
 - ✓ Trapezoid imaging (unilateral, 2 levels adjustable): $14^\circ/18^\circ$
 - ✓ Acoustic window: 28mm $\times$ 10mm
- CWD2.0

- ✓ Application: Trans-cranial
 - ✓ Central frequency: 2MHz
 - ✓ Transducer element: 2
 - ✓ Acoustic window: $\Phi 20\text{mm}$
- CWD5.0

- ✓ Application: Trans-cranial
- ✓ Central frequency: 5MHz
- ✓ Transducer element: 2
- ✓ Acoustic window: $\Phi 14\text{mm}$

11 Peripheral Devices and Accessories

11.1 Printer

- Printer types
 - ✓ Color ink jet printer
 - ✓ B/W video printer
 - ✓ Color video printer
- Print types
 - ✓ Video print
 - ✓ Network print
 - ✓ USB print
 - ✓ Windows print
- Add printer
- Available printer models:
 - ✓ Sony 898
 - ✓ Hp m252n
 - ✓ Brother DCP-710
 - ✓ Cannon CP1300
 - ✓ HP Color LaserJet CP1515n
 - ✓ MITSUBISHI P95
 - ✓ EPSON L130
 - ✓ Sumsung Xpress M2029
 - ✓ HP Ink Tank Wireless 411
 - ✓ HP Ink Tank 319

11.2 Foot Switch

- 2 pedals
- Foot switch: available
- User-defined short-cut keys

11.3 USB Bar Code Scanner

- Bar code input

11.4 DVD R/W Drive

- Export patient data to DVD

- Import patient data from DVD

12 Safety and Certification

- Certification: ISO 9001, ISO 13485
- Comply with:
 - ✓ EN 60601-1 and IEC 60601-1
 - ✓ EN 60601-1-2 and IEC 60601-1-2
 - ✓ EN 60601-1-6 and IEC 60601-1-6
 - ✓ EN 60601-2-37 and IEC 60601-2-37
 - ✓ EN 62304 and IEC 62304
 - ✓ EN 62366-1 and IEC 62366-1
- CE announcement: this system is consistent with EU medical devices directive 93/42/EEC. The code (0197) following CE logo is the number of the notified body by EU, which proves the system is consistent with the directive 93/42/EEC.

NOTE:

- The products or features mentioned in this document may not be commercially available in all countries. Due to regulatory reasons, their future availability cannot be guaranteed.
- SonoScape reserves the right to change the above information, or discontinue any products at any time without any prior notification, and will not be liable for any consequences resulting from the use of this publication.
- Please contact your local SonoScape sales representative for further details.

SonoScape

Manufacturer: SonoScape Medical Corp.

Address: Room 201 & 202, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, 1 Keji Middle 2nd Road, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, 518057, Guangdong, China

Tel: +86-755-26722890

Fax: +86-755-26722850

E-mail: sonoscape@sonoscape.net

www.sonoscape.com

Deklaratë e Garantuesit**SIGURIA E EKZEKUTIMIT**Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **139981****Për Ministria e Shëndetësisë**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **MADEKOS SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: Furnizim me pajisje të Ultrazërit dhe pajisje për Terapinë Okupacionale për Njësitë Shëndetësore të Burgjeve. Lot 1- Pajisje të Ultrazërit

Nr. prokurimit: 206-25-1452-1-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **3,599.80€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **3,599.80€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 75 ditë kalendarike prej **13.06.2025** deri më **27.08.2025**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 13.06.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.