



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë - Ministarstvo zdravstva - Ministry of Health
Divizioni i Prokurimit/Divizia Nabavke/Procurement Division

Prishtine datë, 07.06.2023

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Ministrisë së Shëndetësisë, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 63 të Rregullores për Prokurim Publik të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës **02.06.2023**, të parashtruar nga Operatori Ekonomik **Inovix sh.p.k**, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **"Furnizim me pajisje mjekësore, instrumente mjekësore për Njësitë organizative të QKUK-së"** – LOT 1 me numër prokurimi **206-23-4215-1-1-1** nxjerr:

V E N D I M

1. **Pranohet** kërkesa për ri-shqyrtim e operatorit ekonomik Inovix sh.p.k e dt.02.06.2023 lidhur me aktivitetin e prokurimit "Furnizim me pajisje mjekësore, instrumente mjekësore për Njësitë organizative të QKUK-së" – Lot 1, me numër prokurimi 206-23-4215-1-1-1, kundër Njoftimit për Kontratë të datës 16.04.2023, të publikuar në platformën elektronike;
2. **Korrigjohet**, Specifikimi Teknik për Lot 1;
3. Autoriteti Kontraktues, vazhdon me aktivitetin e prokurimit;
4. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën : <https://e-prokurimi.rks-gov.net>.

A r s y e t i m

Operatori Ekonomik Inovix sh.p.k me datë 02.06.2023 ka parashtruar kërkesën për ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: "Furnizim me pajisje mjekësore, instrumente mjekësore për Njësitë organizative të QKUK-së" – Lot 1, me numër prokurimi 206-23-4215-1-1-1. Autoriteti Kontraktues, sot me datë 07.06.2023, e ka shqyrtuar kërkesën në fjalë si më poshtë:

Dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga AK sipas OE Plusditamed:

- Neni 7- Barazia në Trajtim/ Jo-Diskriminimi dhe
- Neni 28 Specifikimi teknik

Pretendimet ankimore:


Kërkese për rishqyrtim kundër dokumenteve të tenderit dhe njoftimit për kontratë Inovix ne pajtim me Nenin 108/A Paragrafi 3“Kërkesa për shqyrtim duhet të dorëzohet tek autoriteti përkatës kontraktues, me postë ose me çdo mjet tjetër të komunikimit të lejuar me këtë ligj, brenda afateve të mëposhtme” Pika 1 “në qoftë se shkelja e supozuar ka të bëjë me njoftimin e kontratës ose me dokumentet e tenderit brenda pesë (5) ditëve para afatit të fundit për dorëzim të ofertave”, parashtron kërkesë për rishqyrtim kundër

Njesia e kërkesës- Shkel Nenin 7 dhe 28 të LPP-se (Specifikime teknike favorizuese) Përpilimi i specifikimeve teknike të detyrueshme nga njesia e kërkesës per llot 1 artikujt:

1. Inverted Microscope for ICSI/IMSI with micromanipulator and laser
2. Inverted Microscope for ICSI with micromanipulator
3. Phase contrast binocular microscope with LWD 20x objective
4. Stereo Microscope

Te cilet i jane pershtatur pike per pike vetem prodhuesit Zeiss duke permendur edhe emrat e objektivave te cilet jane te krijuar dhe prodhuar vetem nga ky prodhues si psh:

- Sideport 60N L, 2 pozicione kyçjeje
- Tub dylbi 45°/23 mm
- Faza mekanike 130x85 R/L
- Kornizë për montim xhami të ngrohshëm K Termo pllakë me kontrollues (D)
- Mbulesa e pluhurit
- Ndriçimi i dritës së transmetuar me ndriçues HAL 100
- Bartës për ndriçimin e dritës së transmetuar
- Ndriçues HAL 100 me kolektor kuarci
- Llambë me fije drejtkëndore halogjene afërsisht 12V 100W
- Pajisje optike
- Objektivi LD A-Plan 5x/0.15 M27
- Objektivi LD A-Plan 10x/0.25 iHMC M27
- Objektivi LD A-Plan 20x/0.35 iHMC M27
- Objektivi LD A-Plan 40x/0.55 iHMC M27
- Kondensator LD 0,35 H Ph PlasDIC DIC iHMC
- Moduli iHMC 1 0.35/0.4 për kondensator (10x iHMC)
- Moduli iHMC 2 0.35/0.4 për kondensator (20x iHMC)
- Moduli iHMC 3 0.35/0.4 për kondensator (40x/63x iHMC)
- Mikroskop ndihmës, d=30
- Okular PL 10x/23 Br. fokus.
- Mbyllës okulari
- Përshtatës i kamerës 60N-C 1” 1.0x
- Sistemi i mikromanipulimit dhe injektimit për teknikat ICSI (IVF) dhe transgjenike me manipulues të trashë të motorizuar
- MMO-4 Levë e varur me tri boshte Mikromanipulator hidraulik me vaj
- MM94- Manipulator i drejtimit të motorit
- MM94B- Manipulator i drejtimit të motorit
- IM-21 Lloji i vajit mikroinjektor
- IM-11-2 Lloji i ajrit mikroinjektor
- NZ-19-2 Përshtatës për mikroskop të përmbysur

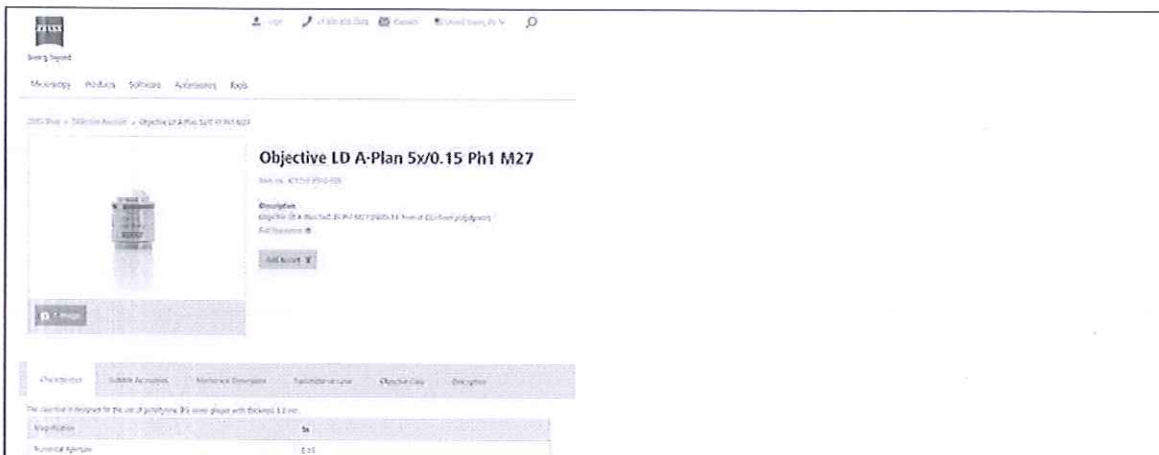

ARTIKULLI 8

Ndersa per artikullin 8 eshte permendur edhe emri i brandit TupbebeX qe tregonqarte se ky produkt i eshte pershtatur 100% vetem prodhuesit te permendur me poshte.

Seti i etiketave të informacionit: Seti i etiketës duhet të printohet me një fjongo (shirit) të veçantë nga printeri i barkodit që do të vendoset në kontejnerët e mostrave (në departamentet e Labororit dhe Andrologjisë) që do të përdoret në laborator. Një numër i mjaftueshëm i mostrave të etiketës printohen në setin e etiketës siç mund të kërkohet për një provë. Etiketat mund të printohen lehtësisht nga çdo kompjuter PC, nga ekрани i përkufizimit të Kartës së Pacientit të sistemit softuerik TupbebeX ID. Etiketat janë plotësisht në përputhje me median e inkubatorit. Nga lagështia, lëngjet etj nuk ndikohen nga faktorët.

BYZYLYKU I PACIENTI ME ÇIP

Janë rripa dore me çipa RFID, të cilat përdoren në dhomat e operacionit, dhomat e dorëzimit të spermës dhe që vendosen në ditët e trajtimit të pacientit, që përmbajnë trajtimin dhe informacionin e identitetit të pacientit. Në pjesën e përparme të rripit të dorës duhet të shkruhet edhe informacioni i identitetit të pacientit, bashkëshortit, llojit të procedurës, dates së lindjes etj. Gjatësia e byzylykut është 230 mm dhe gjerësia e tij është 27 mm.

BYZYLYKU I STAFIT - MBAJTËSE ÇELËSASH OSE KARTË IDENTITETI

Rripat e dorës, mbajtëset e çelësave ose kartat e identitetit janë të përcaktuara / autorizuar për personelin e laboratorit, personelin e sallës së operacionit dhe informacioni i identifikimit të personelit përcaktohet në këto çipa. Identifikimi duhet të bëhet në ekranin e kartave të personelit të sistemit TupbebeX ID. Çdo proces regjistrohet me informacionin e personelit, informacionin e pajisjes, informacionin e datës dhe kohës.

ABOUT US

Who Are We?


Our organization, providing computer services and support services for many small- and middle-sized enterprises since 1996, started to produce project-based special software for various sectors under a new organization with a software team formed in 2006. The company entered the health sector in 2010 and started to develop web-internet projects related to IVF centers in 2011.

With the experience acquired in the health sector since 2010, our firm, which has been carrying out its activities under a new organization titled **DeGoDe Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.**, created **TupBebeX IVF Management Software** in 2012, which is intended solely for IVF Centers. Synthesizing the needs of the IVF sector, our firm created **IVFID Witness System** in 2014, which ensured the safety of all treatment processes and laboratory procedures used in IVF treatments. Our new product came to be used in many centers in a very short time.

Tank Controls, which enables the management and tracking of liquid nitrogen tanks where frozen samples (Embryo, Oocyte and Sperm) are preserved, was presented to the sector in 2017. We have expanded our service range with this product that facilitates the work business processes of embryology – andrology laboratories such as 2D mapping of all frozen samples, tracking of occupation rates and time tracking.

The Laboratory Quality Management System titled **IVF TRACK** has been brought into existence as of 2020.

Our firm continues to develop new products with years of knowledge acquired in the IVF sector.



, ndersa artikullit 8 Software for IVF laboratory with scan and barcode reader per prodhuesin IVFID witness system DeGoDe Teknoloji Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti., created TupBebeX IVF Management Software, bie ndesh me Nenin 28 Paragrafi 2 te LPP-se “Autoriteti kontraktues do t’i përpilojë specifikimet teknike në atë mënyrë që ato të jenë në përputhje me qëllimin e prokurimit dhe të drejtuara drejt sigurimit të qasjes sa më të mirë për të gjithë operatorët e interesuar ekonomik dhe tenderuesit. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar që të hartojë specifikime teknike që favorizojnë ose diskriminojnë një ose më shumë operatorë ekonomik.

Gjithashtu ky përpilim teknike nga njësia e kërkesës është diskriminues për te gjitha prodhues tjerë sepse nuk kane mundësi konkurrimi ne raport me kushte teknike te konkurrences/trajtim i barabarte, andaj kjo bie ndesh me RrUOPP, Neni 20 Paragrafi 3” Specifikimet teknike do të përshkruajnë dhe përkufizojnë, në mënyrë jo-diskriminuese, karakteristikat e obligueshme të objektit të kontratës, siç janë cilësia, performanca, kërkesat e dizajnit, dimensionet, siguria, sigurimi i cilësisë, terminologjia, simbolet, testimi dhe metodat e testimit, paketimi, shënimi dhe etiketimit” dhe paragrafi 4 te ketij Neni “Specifikimet /TER do të jetë e qartë, e saktë dhe precize dhe duhet të mos paraqet kufizime të panevojshme, në mënyrë që të mos kufizohet konkurrenca. Ato duhet të përkufizohen në mënyrë që mos të krijojnë dyshime rreth natyrës së mallrave, punëve ose shërbimeve të kërkuara.

Gjithashtu bie ndesh me parimin e direktivës se Bashkimit Evropian qe është citat ne RrUOPP,Neni 20

Si pale me interes material për te paraqitur ofertë për ketë aktivitet te prokurimit kërkojmë nga njësia e kërkesës te modifikoj specifikimet teknike te detyrueshme për llot 1 artikujt 1, 2, 3, 4, 8 ne mënyre qe te mundësohet konkurrenca ne mes prodhueseve për produktin qe ju kërkoni/nevojat minimale teknike te konkurrencës, pasi qe kjo është procedure e hapur dhe qëllimi i Autoritetit kontraktues sipas LPP-se

është trajtimi i barabartë i OE dhe prodhuesve pjesëmarrës për të arritur qëllimin-Parimin e Ekonomicitetit. Andaj kjo arrihet vetëm kur termat teknike të jenë minimal që përfshijnë disa prodhues në treg që të mundësojnë konkurrencë maksimale në mes Operatorëve ekonomik dhe jo kur paraprakisht si në rastin në fjalë të dihet se cilin prodhues dhe produkt.

Me këtë lloj kufizimi të pjesëmarrjes në këtë aktivitet të prokurimit publik, fituesi është tanimë i paracaktuar të cilit i mundësohet keqperdorimi i buxhetit të Republikës së Kosovës për mbi **450,000 euro** duke u bazuar në cmimet e tregut dhe top brendet si: Nikon dhe Olympus të cilët janë shumë me të specializuar në fushën e IVF.

PROPOZIM

TE APROVOHET- Kërkesa për rishqyrtim si e bazuar.

Te bëhet riformulimi i specifikimit teknik për lot 1 duke hapur mundësinë për pjesëmarrje edhe të OE të tjera duke ofruar brenda të njohura botërore.

Inovix sh.p.k pret përgjigje nga Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit/njësia e kërkesës në afat 3 ditësh në pajtim me Nenin 6 paragrafi 3 të Rregullores për paraqitje të kërkesës për rishqyrtim pranë Autoriteteve Kontraktuese, parashtrim të ankesave pranë OSHP dhe vlera e tarifave të ankesave.

Dëmet materiale

Shpenzimet administrative për këtë tender.

Përgjigjia e Autoriteteit Kontraktues në lidhje me pretendimin Ankimorë të OE

Pranohen pretendimet ankimore të OE Inovix sh.p.k në lidhje me specifikat teknike për Lot 1 (artikujt 1, 2, 3, 4 dhe 8) dhe specifikat korrigjohen përmes sqarimeve shtesë dhe Njoftimit për korrigjim.

Shtyhet fati për ofertim dhe hapje të ofertave për datën 23.06.2023 në ora 14:00.

Në e-prokurim do të bëhet korrigjimi i procedurës përmes Formularit B54.

Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar në ato që u thanë më lart ka vendosur si në dispozitiv.

Këshilla juridike:

Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të paraqesë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa pranë OSHP-se duhet të dorëzohet brenda 10 (dhjetë) diteve pas pranimit të këtij vendimi.

Vendimi i dorëzohet:

1. Inovix sh.p.k
2. Operatorëve ekonomik të interesuar


Berat Marmullaku
Zyrtari përgjegjës i Prokurimit